


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

ПОГОДЖЕНО

« » 2020 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО



ПАСПОРТ

приміщення № 74

кафедра ОПіНС ФІСЕ


Київ

KIMHATA N°74

$S = 47,1 \text{ m}^2$

$V = 120 \text{ m}^3$

$H = 270 \text{ cm}$

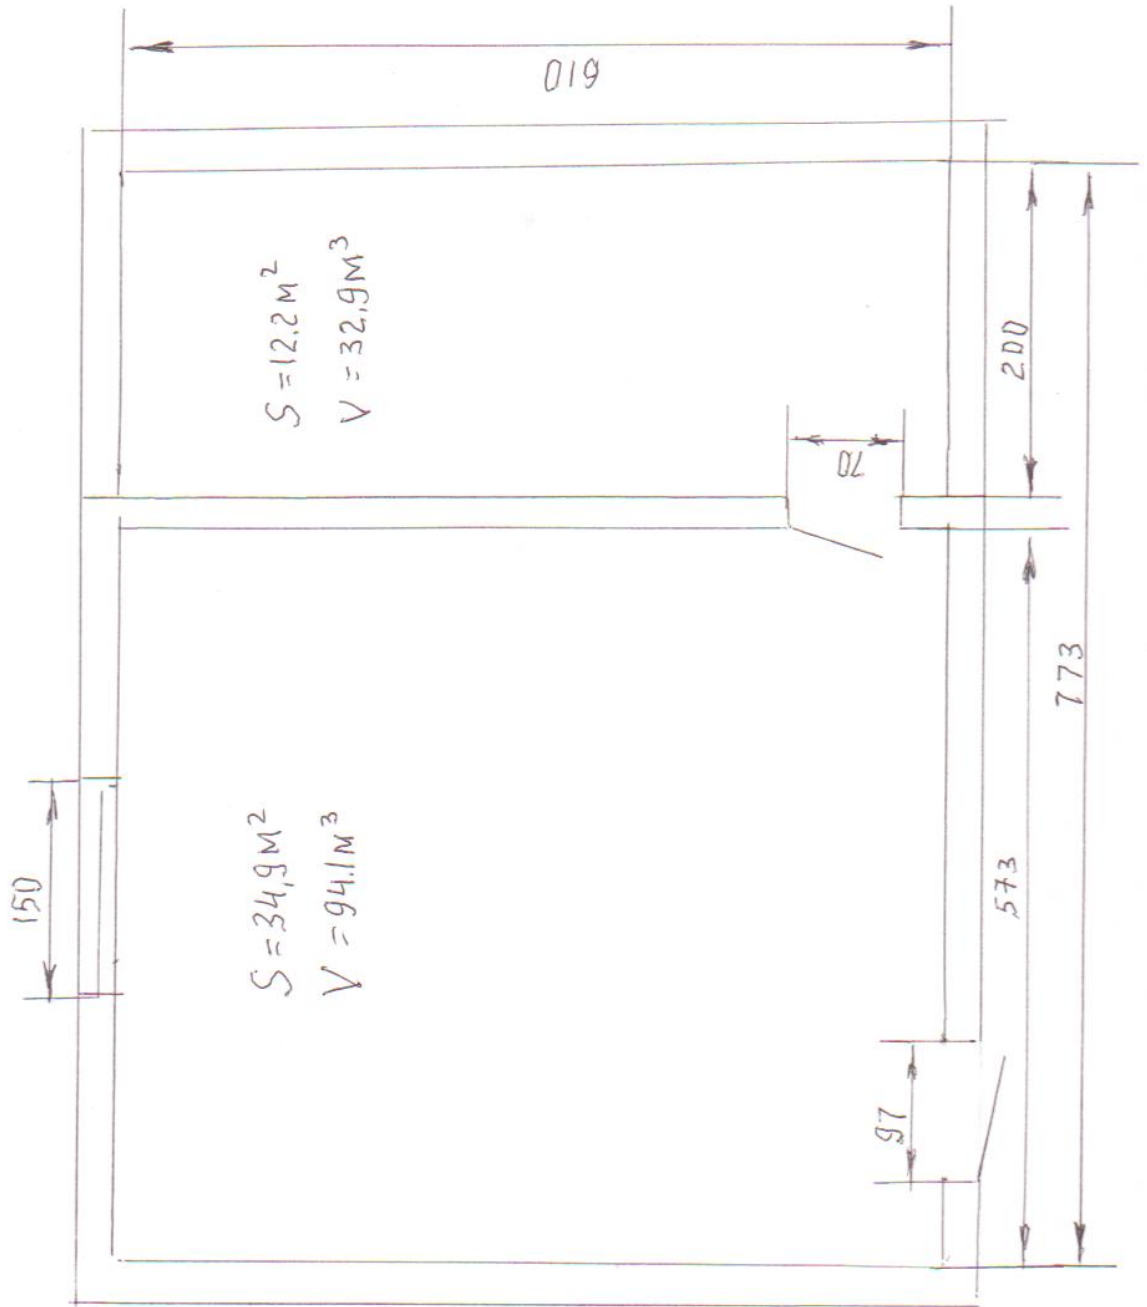

Підрозділ: кафедра ОПіНС

Корпус: головний, просп. Повітрофлотський, 34

Приміщення: № 74

Призначення приміщення:	лабораторія
Робоча площа приміщення:	м ²
Орієнтація приміщення:	
Режим роботи приміщення, кількість працюючих	1 зміна 09:00-18:00, 20 чол.
Двері (кількість, матеріал, стан):	дерев'яні – 1, металеві – 1, задовільний
Освітлення: кількість вікон (стан, матеріал): кількість світильників: тип ламп (розжарювання, денного світла): загальна потужність ламп, кВт:	1, металопластикові - денного світла 2,88
Наявність оргтехніки (вид, кількість):	-
Наявність обладнання	додаток 1
Вентиляція (місцева, загальна, кондиціонер): кількість та тип кондиціонерів:	загальна -
Опалення (централізоване, місцеве):	централізоване
Наявність водопостачання:	централізоване
Наявність шкідливих факторів: шум (вказати джерело): вібрація (вказати джерело): електромагнітне випромінювання (вказати джерело): пил (вказати джерело):	- - - - -
Наявність автономних витяжних систем:	ЭШ-1,3
Використання в робочому процесі небезпечних та шкідливих речовин (вказати, які речовини застосовуються, кількість, концентрація тощо):	-
Покриття підлоги:	керамічна плитка

Начальник

Начальник технічної служби

Інженер технічної служби

Керівник підрозділу

Волошкін О.С.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№	Назва	Серія, номер	Кількість
1	Ваги лабораторні цифрові	-	1
2	Електрична плита настільна	-	1
3	Мікроскоп біологічний	XSP-139 ULAB	1
4	Мікроскоп біологічний	Levenhuk 700	1
5	Мікроскоп біологічний цифровий	-	1
6	Мікроскоп біологічний оптичний	-	2
7	Стерилізатор повітряний	ГП-40	1
8	Спиртівка	СЛ-2	2
9	Термостат	ТС-80М-2	1
10	Термостат	ТС-80	1
11	Центрифуга клінічна	LabAnalyt DM 0412	1
12	Стерилізатор паровий (автоклав)	ГК-20	1